

Manuale operatore Iridigit 3.0





Inserire nella slitta flash della fotocamera l'Iridigit come in figura e ruotare la ghiera con righe antiscivolo per mettere in sicurezza l'apparecchio.




Avvitare alla ghiera portafiltri dell'obiettivo il dispositivo con led bianchi. Allentando i 3 grani della ghiera con filettatura fare in modo che il cavo elettrico si trovi in alto,

quindi serrare i grani.



Collegare i 2 connettori del dispositivo frontale (avvitato all'obiettivo) alla scatola con elettronica montata in precedenza sul corpo macchina.

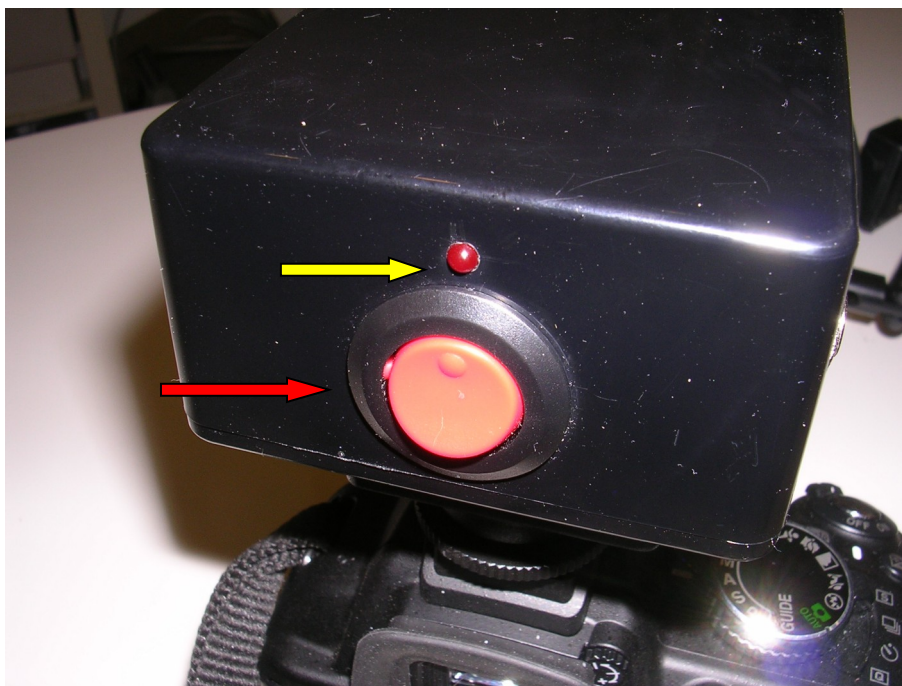

Accendere il flash tramite l'interruttore rosso e attendere l'accensione del led (freccia gialla), a questo punto l'Iridigit è pronto per scattare.



Connettore per collegare il caricabatteria
Attenzione! Durante la ricarica degli accumulatori, l'interruttore deve essere su OFF



Pomo per la regolazione dell'intensità delle luci bianche frontali



Impostare la fotocamera in modalità "Manuale"



Impostare il tempo di esposizione su 1/125 sec ed il diaframma su F11/16




Impostare il bilanciamento del bianco (WB) su luce flash



Impostare la sensibilità ISO su 200

A questo punto ruotare la ghiera fuoco dell'obiettivo alla minima distanza operativa ed utilizzarlo in Manual Focus.

Dopo il primo scatto, controllare la fotografia ed eventualmente correggere l'esposizione modificando i valori dei diaframmi.

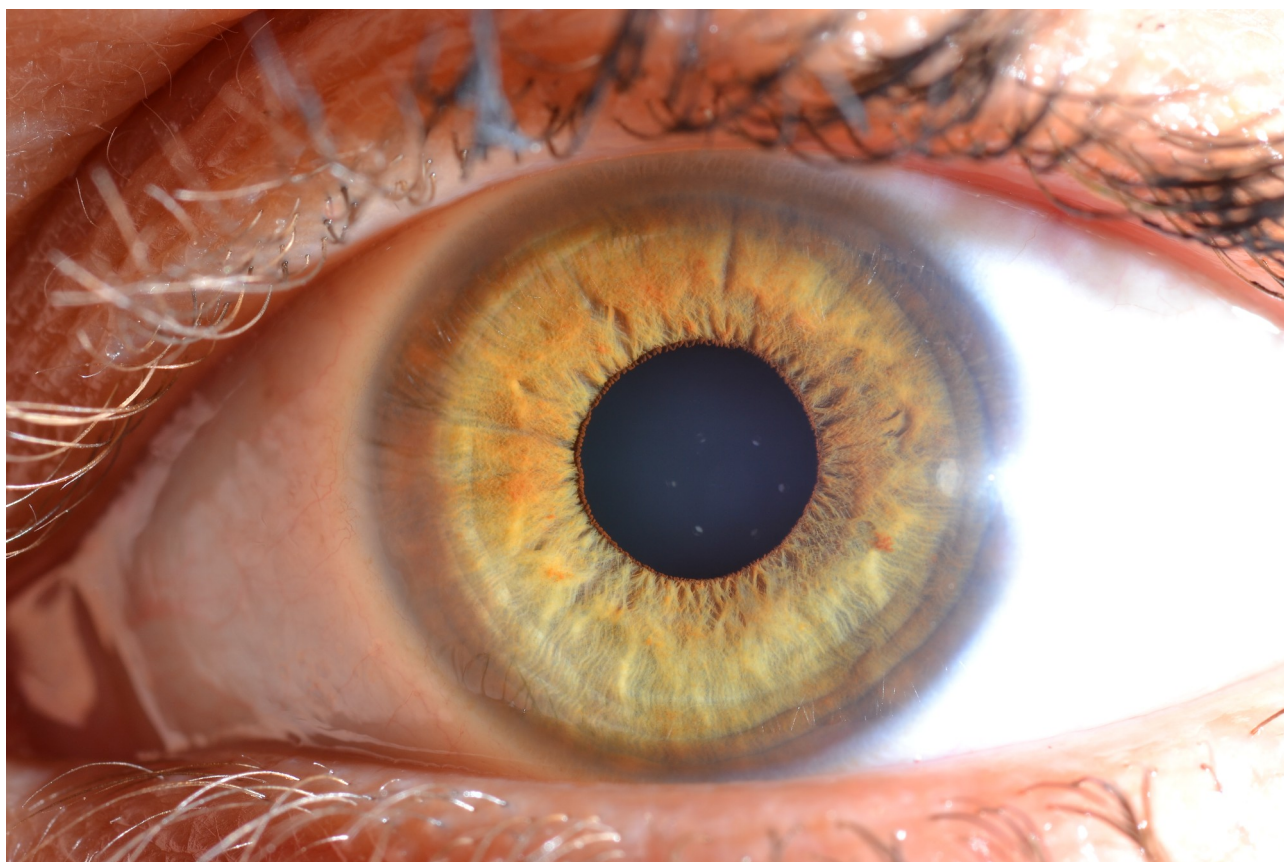

OMD officine meccaniche d'onorio – Via Taurianova, 81/85 – 00178 Roma – tel 06-60659964
www.omdonorio.com – info@omdonorio.com